

SHIMADZU


LabSolutions

分析报告

〈样品信息〉

样品名 : A
 批处理文件名 : SEC-HPLC
 样品瓶号 : 1-3
 进样体积 : 20 μ L
 分析日期 : 2019/1/20 8:30:25
 处理日期 : 2019/1/20 9:45:12
 样品类型 : 未知
 分析者 : System Administrator
 处理者 : System Administrator

〈色谱图〉

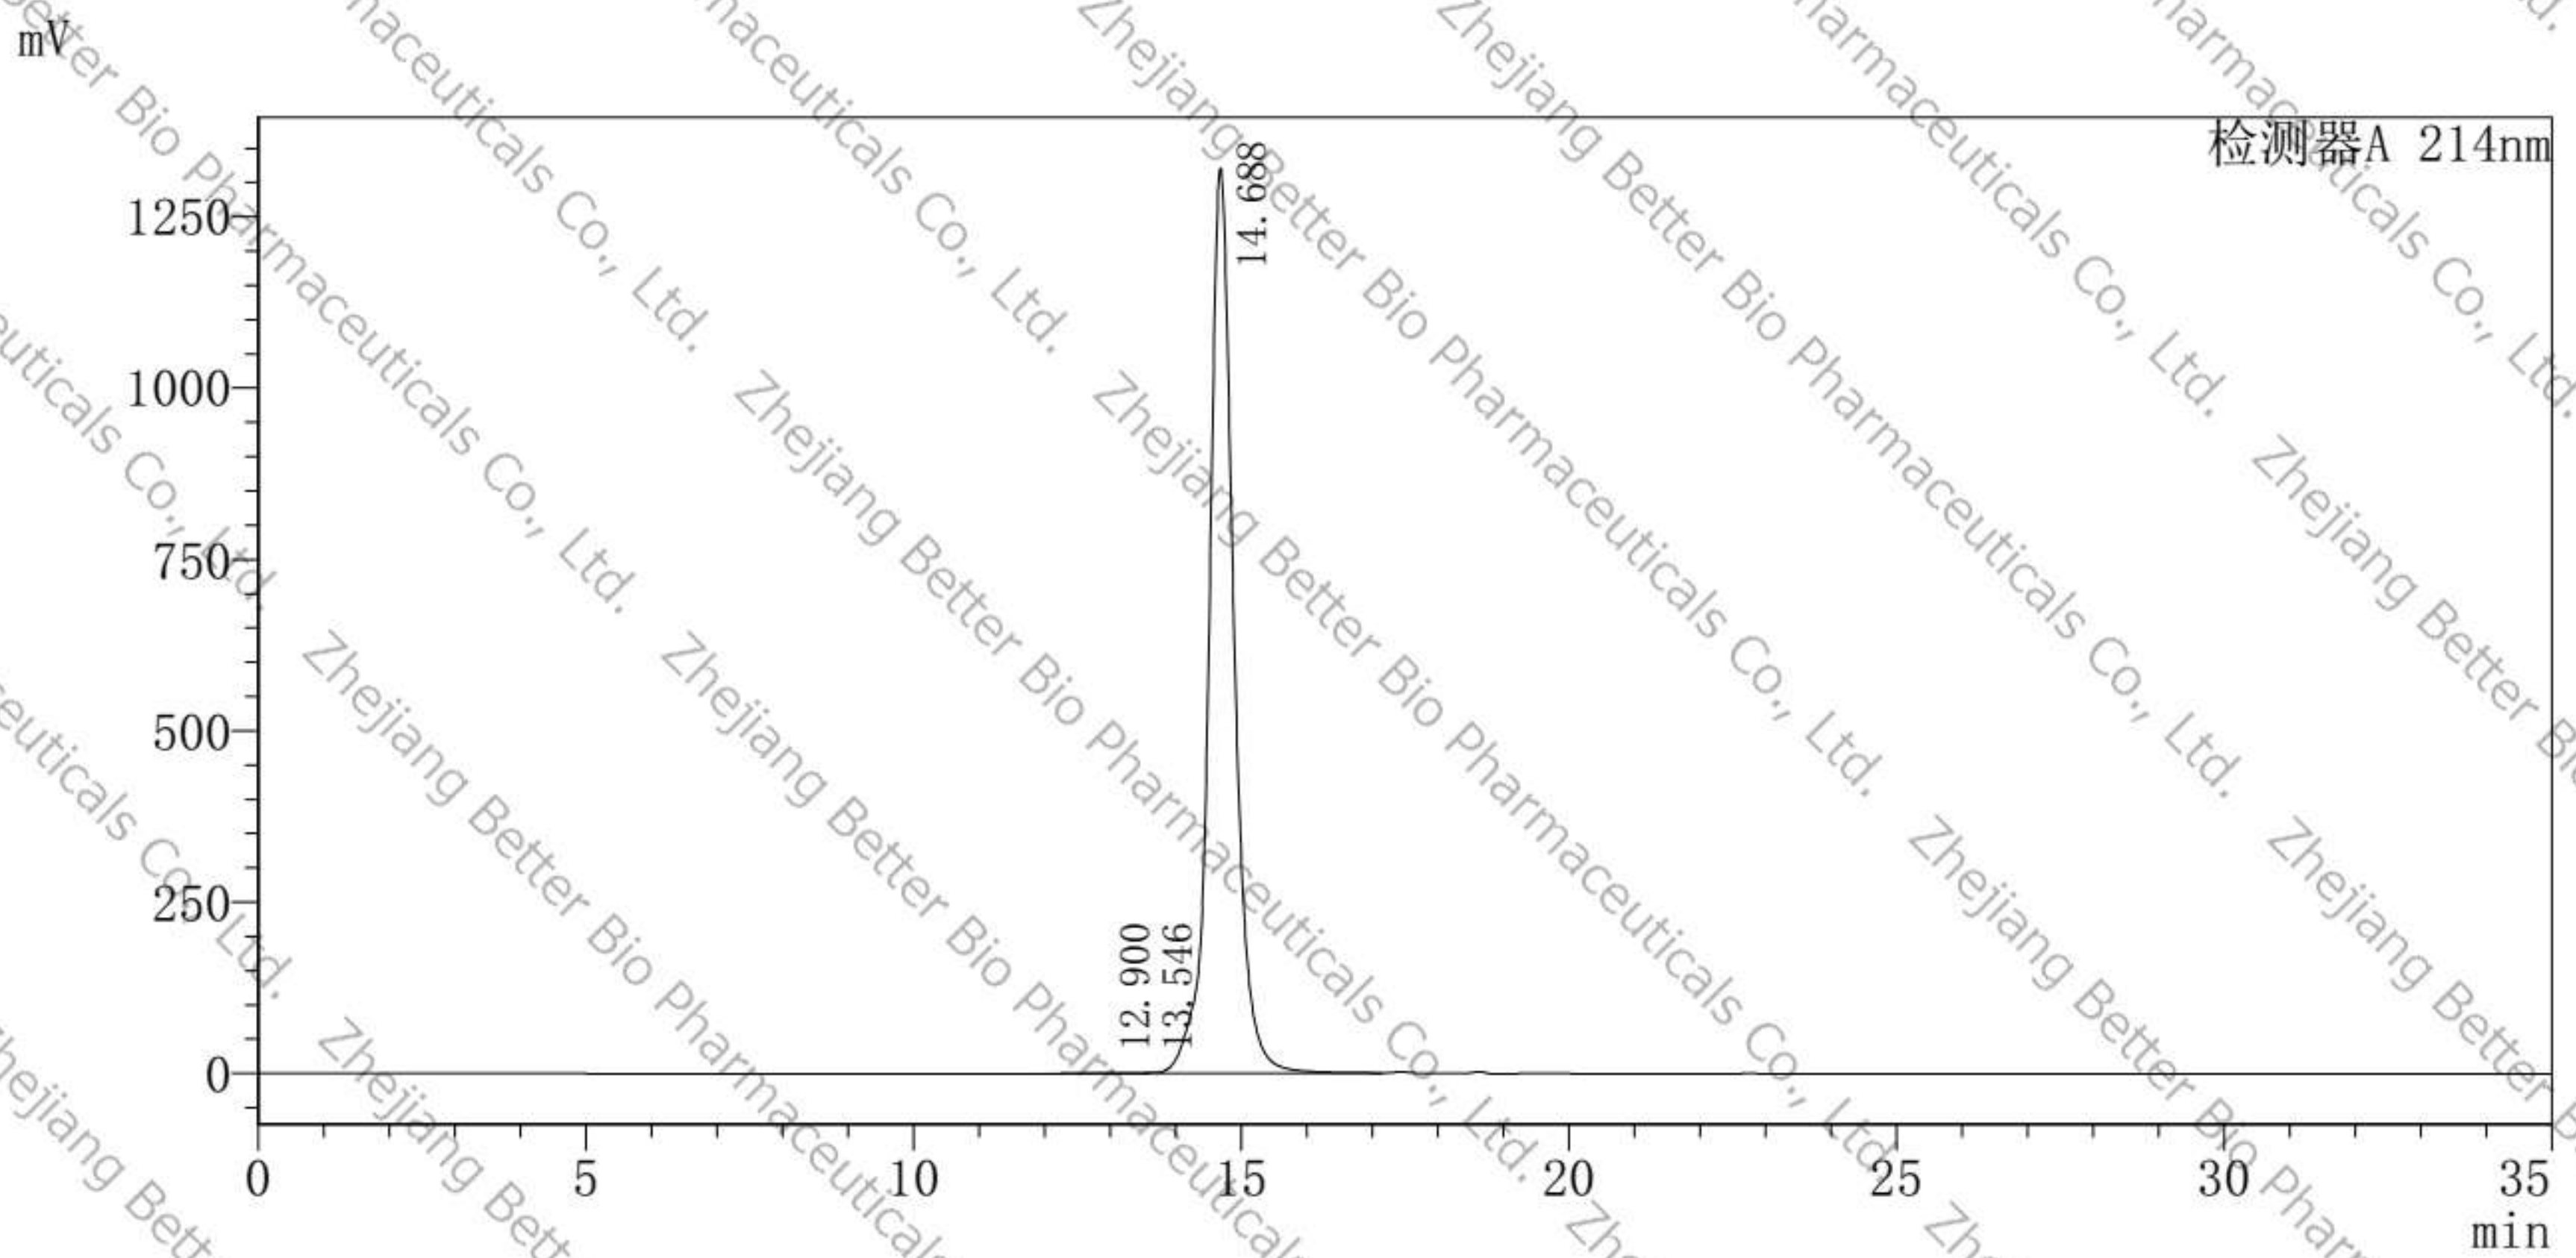

〈峰表〉

检测器A 214nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子
1	12.900	8820	289	0.025	1921	
2	13.546	14789	713	0.042	3	
3	14.688	35081238	1320996	99.933	8189	1.028
总计		35104846	1321999	100.000		